



包装変更のお知らせ

非イオン性尿路・血管造影剤

イオパミロン[®]注 150/300/370 イオパミロン[®]注 300 シリンジ/370 シリンジ

2013年10月

バイエル薬品株式会社

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、「イオパミロン[®]注 150/300/370」および「イオパミロン[®]注 300 シリンジ/370 シリンジ」の包装につきまして、Bracco Imaging社との業務提携契約に伴い、デザインの一部を変更いたしますことをご案内申し上げます。

なお、本変更に伴う各種コード・番号および包装サイズに変更はございません。


今後とも尚一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 変更内容：Bracco Imaging社のロゴ表示の追加、またはサイズの変更

(例) イオパミロン[®]注 300 シリンジ 100mL ピロー包装

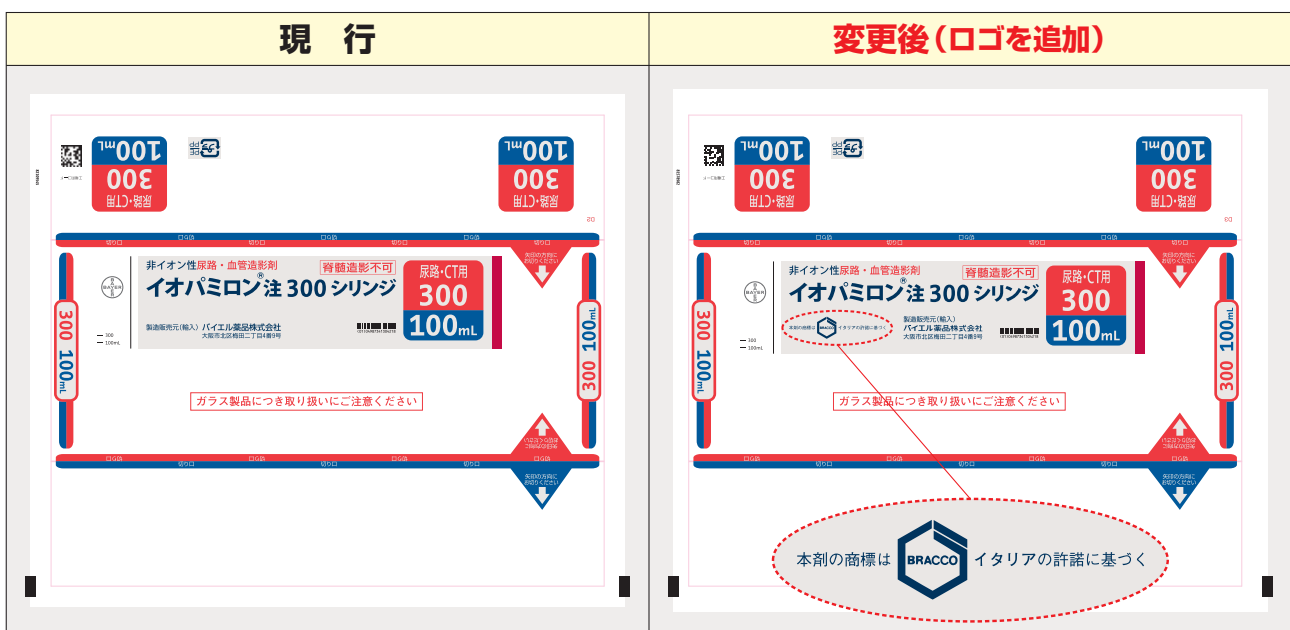

■ 対象製品の出荷予定時期：2013年11月上旬より順次